

NovoPen® 4

Návod na používanie

Pred podávaním inzulínu si pozorne
prečítajte návod na používanie NovoPen® 4

Stručný návod nájdete na zadnej
strane tohto návodu.



Obsah

Prehľad častí pera	Vnútri obalu	
Úvod	Vnútri obalu	
Dôležité poznámky	1	
Príprava pera na injekciu		
Vložte inzulínovú náplň	2	
Ak používate bielu a zakalenú inzulínovú suspenziu	5	
Nasaďte novú ihlu	6	
VŽDY pred podávaním injekcie preskúšajte prietok inzulínu	8	
Nastavte dávku	10	
Podajte si dávku	12	
Po podaní injekcie	14	
Ako skontrolovať kol'ko inzulínu zostało	16	
Ak potrebujete viac ako 60 jednotiek	17	
Ak potrebujete viac inzulínu ako zostało v náplni	18	
Ako vymeniť použitú inzulínovú náplň	20	
Ako sa staráť o pero		
Starostlivosť	22	
Čistenie	22	
Uchovávanie	23	
Likvidácia	23	
Záruka	24	

NovoPen® 4

Pero



Kryt pera



Stupnica
inzulínu



Držiak
náplne

Hlava tyčového
piesta



Tyčový
piest

Ukazovateľ
dávky



Počítadlo
dávky

Dávkovacie
tlačidlo



Číslo
šarže

Jednorazová ihla (vzor)



Vonkajší
kryt ihly



Vnútorný
kryt ihly



Ihla



Papierový
štítok

Inzulínová náplň (náplň Penfill® 3 ml)



Uzáver so
závitom
(na nasadenie ihly)



Farebný
prúžok



Sklenená
guľôčka
(len v bielej
a zakalenej
inzulínevej
suspenzii)



Piest

Úvod

**Ďakujeme, že ste si vybrali NovoPen® 4.
NovoPen® 4 je inzulínové pero na opakované používanie.**

Pred použitím pera si pozorne prečítajte tento návod – aj keď ste už predtým používali NovoPen® 4 alebo podobný aplikačný systém od spoločnosti Novo Nordisk. Vysvetlí vám všetko potrebné, čo potrebujete vedieť o peru a ako ho používať.

Nepoužívajte NovoPen® 4 bez riadneho zaškolenia od zdravotníckeho pracovníka. Predtým ako začnete liečbu, presvedčte sa, že ste si istý v príprave injekcie pomocou pera.

NovoPen® 4 je injekčné pero na opakované používanie na podávanie inzulínu, ktorý si pacient s diabetom podáva sám. K injekčnému peru sa používajú inzulínové náplne Penfill® 3 ml od spoločnosti Novo Nordisk a jednorazové ihly (dodávané samostatne). Injekčné pero umožňuje používateľovi nastavenie požadovaných dávok od 1 do 60 jednotiek s pridaním po 1 jednotke.

Pero je určené na opakované používanie, čo znamená, že ho môžete použiť viackrát. Keď spotrebujete všetok inzulín v náplni, jednoducho vymeníte náplň za novú.

NovoPen® 4 je dostupné v striebornej a modrej farbe.

Vždy pred každou injekciou nezabudnite skontrolovať názov a farbu náplne, aby ste sa presvedčili, že obsahuje správny typ inzulínu.

Zámena dvoch inzulínov môže mať vázne zdravotné následky. Preto sa odporúča, ak používate dva typy inzulínu, aby ste prediskutovali so svojím lekárom, ako predísť zámene.

O tomto návode na používanie:

V tomto návode sa postupne uvádzajú pokyny ako používať pero.

Dôležité informácie a doplňujúce informácie sú jasne vyznačené symbolmi, ktoré vidíte nižšie:



Dôležité informácie

Venujte zvláštnu pozornosť týmto poznámkom, pretože sú dôležité pre bezpečné používanie pera. Ak nebudeste dôsledne postupovať podľa pokynov, môžete si podať príliš málo alebo príliš veľa inzulínu, alebo si nepodáte žiadnen inzulín.




Doplňujúce informácie

! Dôležité poznámky

- **Ak ste slabozraký alebo máte vážne problémy so zrakom, nepoužívajte NovoPen® 4 bez pomoci.** Požiadajte o pomoc osobu s dobrým zrakom, ktorá je vyškolená v používaní NovoPen® 4.
- **VŽDY pred podaním každej injekcie, preskúšajte prietok inzulínu.** Nepoužívajte pero, ak inzulín nevystrekne z hrotu ihly pri skúške prietoku. Ak nepreskúšate prietok inzulínu, môžete si podať príliš málo alebo príliš veľa inzulínu alebo si nepodáte žiaden inzulín.
- **Ak vám pero spadne,** skontrolujte inzulínovú náplň, či nie je poškodená, napríklad prasknutá. Ak je potrebné, vymeňte náplň za novú.
- **Ak náhodou oddelíte časti pera od seba** medzi jednotlivými podávaniami injekcie, je dôležité preskúšať prietok inzulínu pred ďalším podávaním injekcie. Možno to budete musieť urobiť niekoľkokrát, až dovtedy kým inzulín vystrekne z hrotu ihly. Ak sa inzulín neobjaví, môže sa stať, že si nepodáte žiaden inzulín.
- **NovoPen® 4 je určené na používanie s náplňami Penfill® 3 ml a jednorazovými ihlami NovoFine® alebo NovoTwist®** s dĺžkou do 8 mm.
Spoločnosť Novo Nordisk nenesie zodpovednosť za poškodenie pera NovoPen® 4, spôsobené použitím iných pomôcok ako sú vyššie uvedené.
- **Vždy skontrolujte názov a farbu náplne,** aby ste sa presvedčili, že obsahuje ten typ inzulínu, ktorý potrebujete. Ak si podáte nesprávny typ inzulínu, hladina cukru v krvi sa môže príliš zvýšiť alebo príliš znížiť.
- **Vždy nosťte pri sebe rezervné pero,** inzulín navyše rovnakého typu (typov) ako používate a ihly, pre prípad straty alebo poškodenia.
- **Nikdy neposkytujte pero,** inzulínové náplne a ihly iným osobám. Sú určené len pre vás.
- **Vždy uchovávajte pero,** inzulínové náplne a ihly **mimo dohľadu a dosahu iných ľudí, zvlášť detí.**
- **Vždy nosťte pero so sebou.** Nenechávajte ho v aute alebo na inom mieste, kde sa môže príliš zohriať alebo ochladniť.
- Opatrovatelia musia **byť pri manipulácii s použitými ihlami veľmi opatrní**, aby predišli riziku poranenia ihlou a prenosu infekcie.


2 Vložte inzulínovú náplň

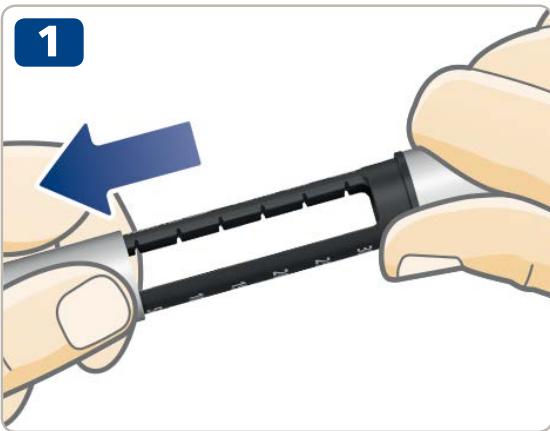

- Stiahnite kryt pera.



- Odkrúťte držiak náplne. Odložte ho bokom na neskoršie použitie.

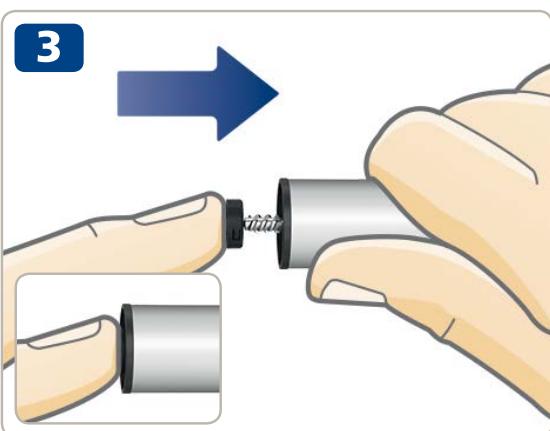

- **Tyčový piest sa môže vysunúť** z pera. Ak áno, **zasuňte ho úplne do vnútra**, až kým sa nezastaví.



Tyčový piest a hlava piesta sa môžu pohnúť samovoľne. To je prirodzené a nemá to vplyv na funkciu pera.

- Zoberte novú inzulínovú náplň. Držte čierny držiak náplne a nechajte náplň vklíznuť uzáverom **so závitom smerom dopredu**, ako je zobrazené. Farba vašej náplne sa môže lísiť od tej na obrázku. Závisí to od typu inzulínu, ktorý používate.




Skontrolujte názov a farbu náplne, aby ste sa presvedčili, že obsahuje ten typ inzulínu, ktorý potrebujete. Ak si podáte nesprávny typ inzulínu, hladina cukru v krvi sa môže príliš zvýšiť alebo príliš znížiť.

Skontrolujte, či náplň nie je poškodená, napríklad prasknutá. Ako to urobiť, pozrite v písomnej informácii pre používateľa **pre náplň Penfill® 3 ml, ktorá je vložená v balení náplní Penfill® 3 ml.**


Skontrolujte, či inzulín vyzerá tak, ako má vyzerať. V písomnej informácii pre používateľa pre náplne Penfill® 3 ml nájdete informáciu, ako má váš typ inzulínu vyzerať.

NovoPen® 4 je určené na používanie s náplňami Penfill® 3 ml a jednorazovými ihlami s dĺžkou do 8 mm NovoFine® alebo NovoTwist®.

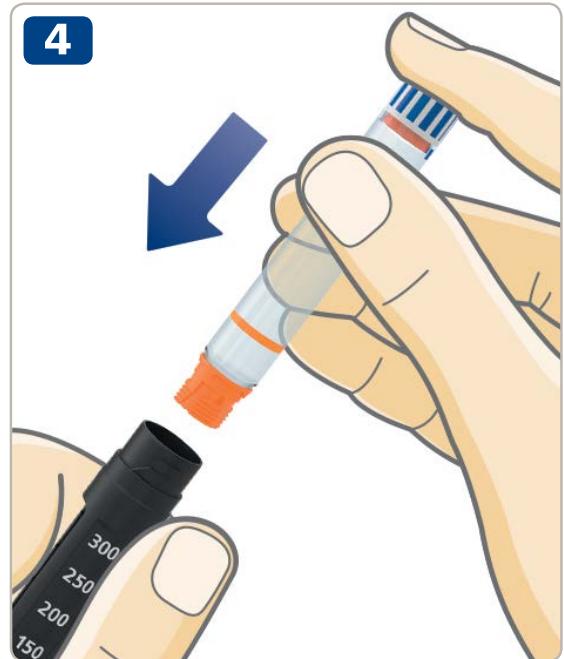

5

- Zakrúťte držiak náplne naspäť, tak ako je zobrazené, až kým nepočujete alebo nepocítite kliknutie.

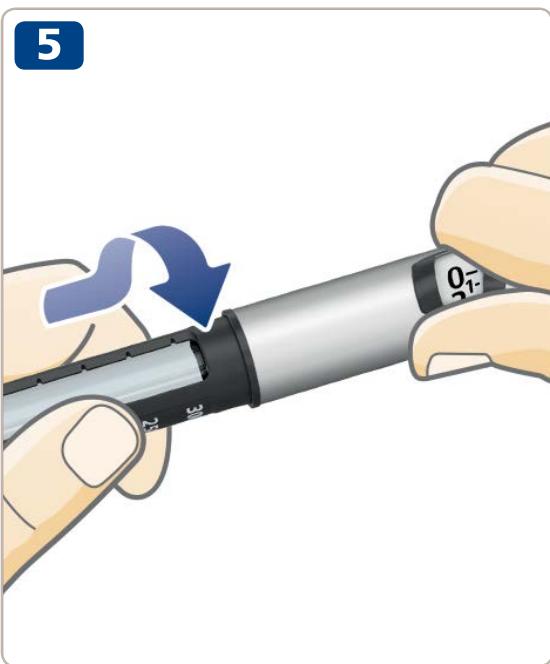

Ak používate bielu a zakalenú inzulínovú suspenziu

Ak používate inzulínovú náplň s bielou a zakalenou inzulínovou suspenziou, **vždy ju tesne pred podávaním injekcie resuspendujte (premiešajte)**. Pozrite písomnú informáciu pre používateľa pre náplň Penfill® 3 ml ako resuspendovať tento typ inzulínu.


Predtým ako budete resuspendovať inzulín, **presvedčte sa, že vo vnútri náplne** je dosť miesta: Piest musí byť **nad bielym prúžkom** na držiaku náplne, keď držíte pero, ako je zobrazené. To je nutné, aby sa mohla sklenená guľôčka vnútri náplne voľne pohybovať, aby sa resuspendoval inzulín.

Ak je piest pod bielym prúžkom, vymeňte túto náplň za novú, pozri strany 20-21.




6 Nasad'te novú ihlu

1

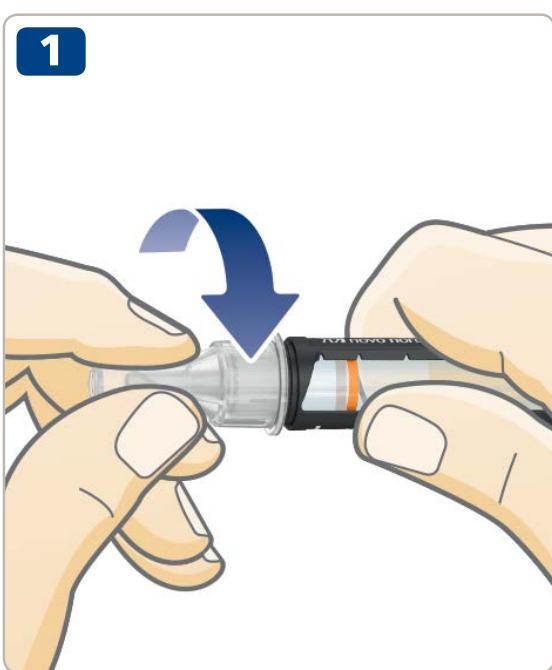

- Zoberte novú ihlu a odtrhnite papierový štítok.
- Zatlačte ihlu **rovno** na pero. **Otáčajte, až kým nie je upevnená.**

2

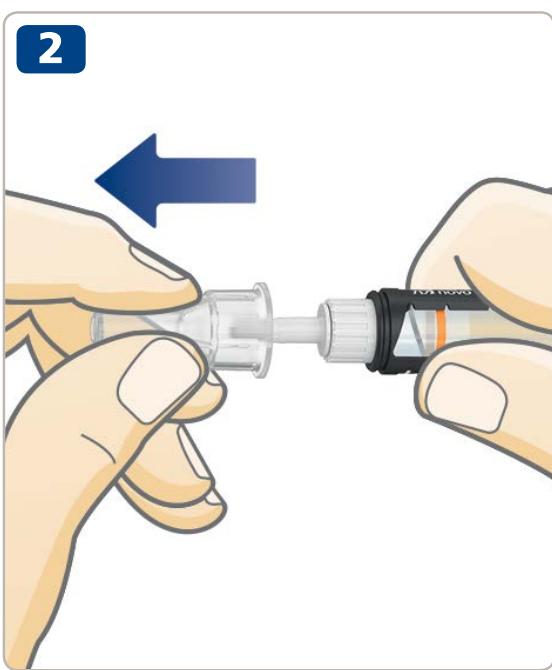


- Stiahnite vonkajší kryt ihly a odložte si ho. Budete ho potrebovať po podaní injekcie, aby ste ihlu bezpečne odstránili z pera.



Ihra je uzavorená dvoma krytmi. Musíte dať dolu obidva kryty. Ak zabudnete dať dolu obidva kryty, nepodáte si žiadnen inzulín a hladina cukru v krvi sa môže príliš zvýšiť.

- Opatrne stiahnite vnútorný kryt ihly a odhodťte ho.
Na hrote ihly sa môže objaviť kvapka inzulínu. To je normálne, ale musíte **aj tak preskúšať prietok inzulínu.**

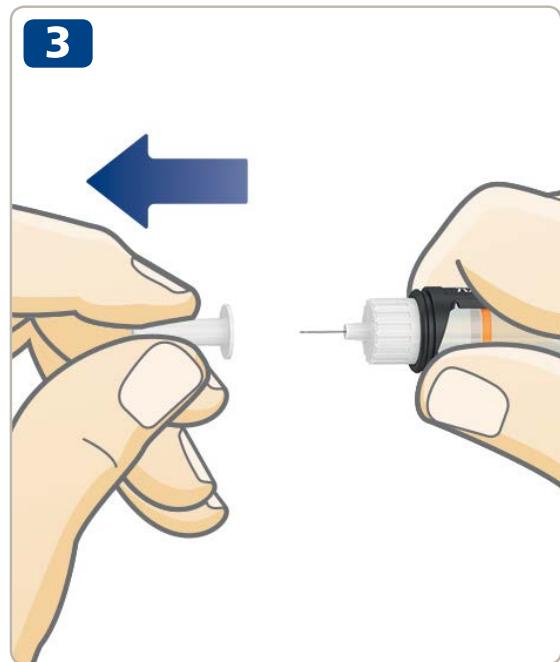

Na každú injekciu použite vždy novú ihlu. To znižuje riziko upchatia ihiel, kontaminácie, infekcie a nepresného dávkovania.

Nikdy nepoužite ohnutú alebo poškodenú ihlu.

Nenasadzujte novú ihlu na pero, pokiaľ nie ste pripravený na nasledujúcu injekciu.



NovoPen® 4 je určené na používanie s náplňami Penfill® 3 ml a jednorazovými ihlami s dĺžkou do 8 mm NovoFine® alebo NovoTwist®.

8 VŽDY pred podávaním injekcie, preskúšajte prietok inzulínu

1




VŽDY pred podávaním injekcie, preskúšajte prietok inzulínu.

Skúšajte, až kým inzulín vystrekne z hrotu ihly. Tým zaistíte, že sa odstránia všetky medzery a vzduchové bubliny a že inzulín prejde cez ihlu.

- **Vytiahnite dávkovacie tlačidlo**, ak nie je už vytiahnuté.

2

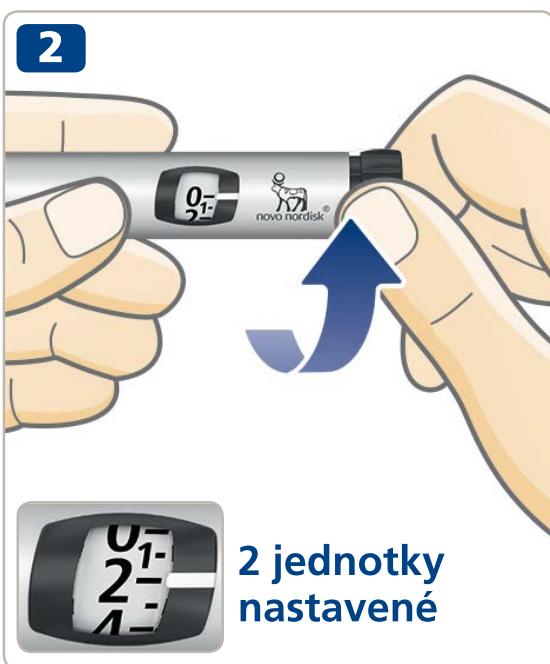

- Otočte dávkovacie tlačidlo tak, aby ste nastavili **2 jednotky**.

- **Tlačte dávkovacie tlačidlo, až kým počítadlo dávky zobrazí "0".**

"0" musí byť zarovno s ukazovateľom dávky.

- Skontrolujte, či **inzulín vystrekol** z hrotu ihly.

Ak sa neobjaví žiadny inzulín, opakujte kroky 1-3, až kým inzulín vystrekne z hrotu ihly.



Ak sa inzulín neobjaví po viacerých pokusoch, skontrolujte inzulínové okienko, či vidíte medzeru medzi čiernou hlavou tyčového piesta a piestom, *pozrite obrázky 3A a 3B*. Ak nevidíte medzeru, vymeňte ihlu a preskúšajte, znova prietok inzulínu.

Skúška prietoku inzulínu je ukončená, keď vidíte inzulín vystreknutý z hrotu ihly.



Nepokúšajte sa podávať si injekciu, ak sa neobjavil žiadny inzulín. Možno si nepodáte žiadnen inzulín, aj keď sa počítadlo dávky mohlo pohnúť. To môže viest k príliš vysokej hladine cukru v krvi (hyperglykémia).

Ak sa po opakovanom preskúšaní prietoku neobjaví inzulín, nepoužívajte toto pero. Obráťte sa na dodávateľa a požiadajte o nové pero.

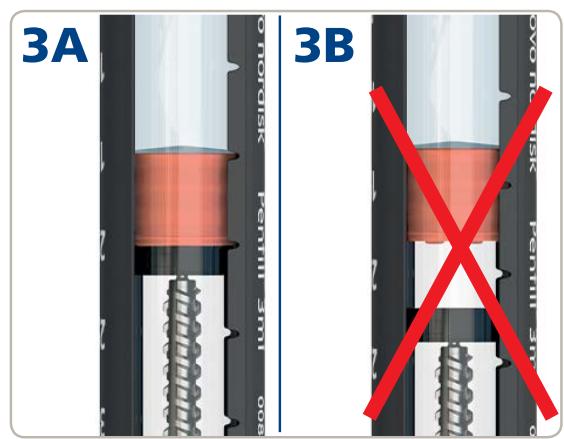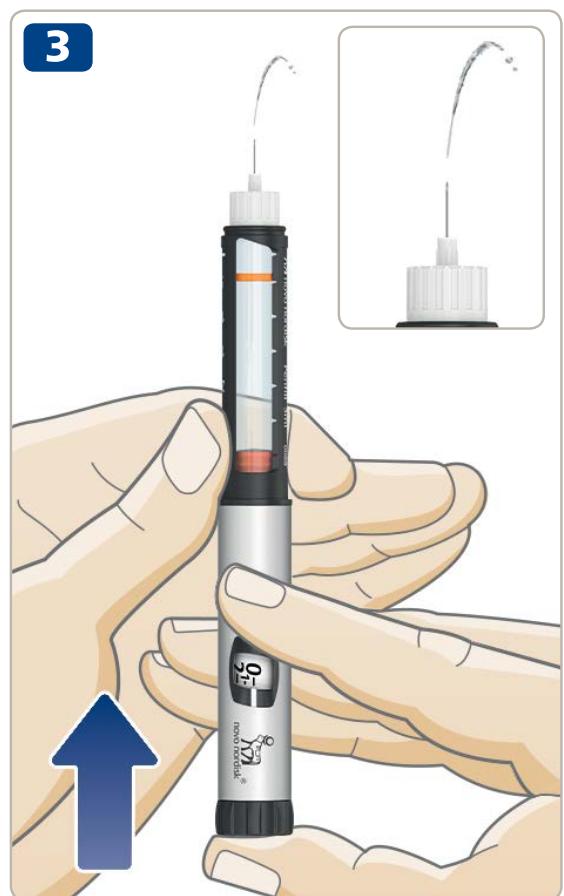


10 Nastavte dávku

1



- Vytiahnite dávkovacie tlačidlo, ak nie je už vytiahnuté.
- Predtým ako začnete, presvedčte sa, že počítadlo dávky ukazuje "0". "0" musí byť zarovno s ukazovateľom dávky.

2

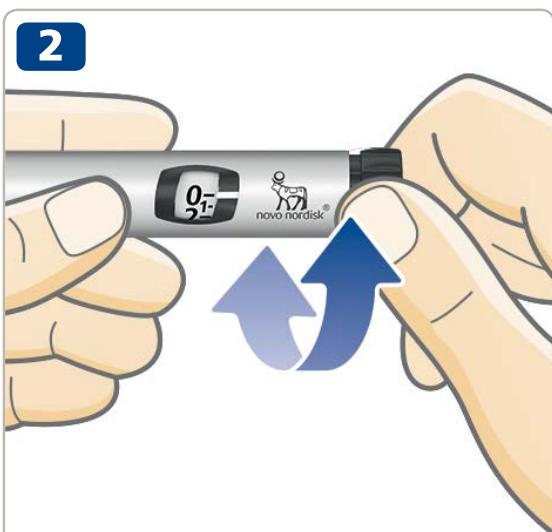

- Otáčajte dávkovacím tlačidlom, aby ste si nastavili dávku, ktorú potrebujete. Môžete otáčať dávkovacím tlačidlom dopredu alebo dozadu, aby ste nastavili dávku.



5 jednotiek
nastavených



24 jednotiek
nastavených



Dávkovacie tlačidlo mení počet nastavených jednotiek. Len počítadlo dávky a ukazovateľ dávky ukazujú, koľko jednotiek ste si nastavili na jednu dávku. Môžete si nastaviť až 60 jednotiek na jednu dávku.



Vždy pozerajte cez inzulínové okienko, **aby ste sa presvedčili, že inzulín v pere vyzerá, tak ako má.** V písomnej informácii pre používateľa pre náplne Penfill® 3 ml nájdete informáciu, ako má váš typ inzulínu vyzeráť.

Vždy používajte počítadlo dávky a ukazovateľ dávky, aby ste videli, koľko jednotiek ste si nastavili.

Nepoužívajte stupnicu inzulínu na držiaku náplne, aby ste odmerali dávku. Tá ukazuje len približne, koľko inzulínu zostalo v pere.

Nepočítajte kliknutia pera, aby ste nastavili dávku.

Ak si nastavíte a podáte nesprávnu dávku, hladina cukru v krvi sa môže príliš zvýšiť alebo príliš znížiť.



Ak potrebujete viac ako 60 jednotiek, môžete si vybrať inú pomôcku spoločnosti Novo Nordisk na podávanie inzulínu, ktorá má vyššiu maximálnu dávku.

Dávkovacie tlačidlo sa ľahko otáča. Pri otáčaní netreba použiť silu.

Ak pero obsahuje menej ako 60 jednotiek, počítadlo dávky zastane na počte zostávajúcich jednotiek. Ak potrebujete viac inzulínu, ako zostało v náplni, *pozrite strany 18-19.*

12 Podajte si dávku

1



VŽDY pred podávaním injekcie, preskúšajte prietok inzulínu.

- **Skontrolujte názov a farbu** náplne, aby ste sa presvedčili, že obsahuje ten typ inzulínu, ktorý potrebujete. Ak si podáte nesprávny inzulín, hladina cukru v krvi sa môže príliš zvýšiť alebo príliš znížiť.
- **Zaved'te si ihlu do kože**, ako vám ukazál lekár.
- **Presvedčte sa, že vidíte počítadlo dávky**.
- **Tlačte dávkovacie tlačidlo**, až kým počítadlo dávky zobrazí "0". "0" musí byť zarovno s ukazovateľom dávky. Potom môžete počuť alebo pocítiť kliknutie.

2

Čakajte a
pomaly počítajte
1-2-3-4-5-6



- Potom ako sa počítadlo dávky vrátilo na "0", **držte ihlu v koži a pomaly počítajte do 6**. Ak ihlu vytiahnete skôr, môžete vidieť vytokať inzulín z hrotu ihly. Ak sa tak stane, nebude podaná celá dávka, a mali by ste si častejšie kontrolovať hladinu krvného cukru.

- Vytiahnite ihlu z kože.




**Vždy si podávajte injekciu stlačením dávkovacieho tlačidla.
Neotáčajte ho.** Ak otočíte dávkovacie tlačidlo, **nepodáte** si inzulín.

**Vždy sledujte počítadlo dávky, aby ste vedeli kol'ko jednotiek
ste si podali.** Nepočítajte kliknutia pera. Počítadlo dávky ukazuje
presný počet jednotiek.

Ak sa dávkovacie tlačidlo zastaví predtým, ako počítadlo dávky
ukáže "0", ihla môže byť upchatá. Otočte počítadlo dávky späť na
"0" a vymeňte ihlu za novú. Preskúšajte prietok inzulínu a podajte
si celú dávku.



Po podaní injekcie môžete vidieť kvapku inzulínu na hrote ihly.
To je normálne a nemá to vplyv na dávku.

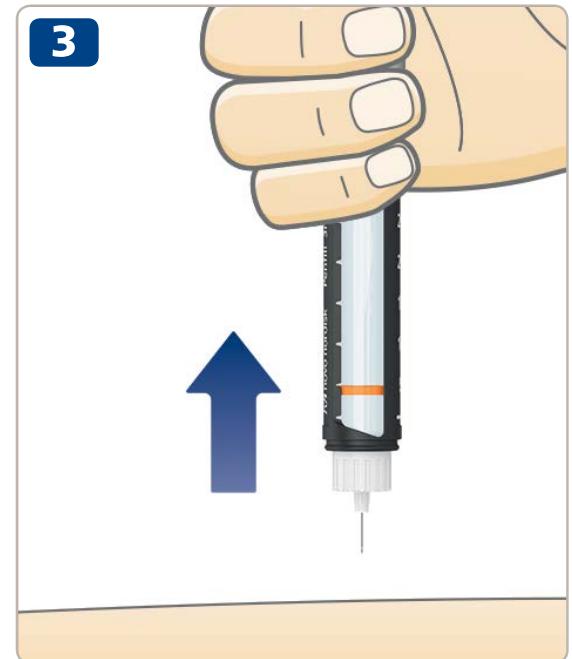

14 Po podaní injekcie



- Ihlu ihned' odstráňte odkrútením do nádoby na ostré predmety.



- Ak nemáte nádobu na ostré predmety, postupujte metódou zakrycia ihly. **Na rovnej ploche vsuňte hrot ihly do vonkajšieho krytu ihly** bez toho, aby ste sa jej dotkli.
- Nedotýkajte sa vonkajšieho krytu ihly predtým, kým nezakryje ihlu.



- Ked' je ihla zakrytá, **opatrne zatlačte vonkajší kryt ihly na doraz.**



Nikdy sa nepokúšajte dať vnútorný kryt ihly naspäť na ihlu.
Mohli by ste sa ihlou pichnúť.


- Držte čierny držiak náplne a odkrúťte ihlu. Opatrne ju odhodťte tak, ako vám povedal lekár.



- Po každom použití **dajte kryt pero** na pero, na ochranu inzulínu pred svetlom.
- Starostlivo uchovávajte pero. Pero uchovávajte **mimo dohľadu a dosahu iných ľudí, najmä detí**, pozrite stranu 23 ako uchovávať pero.



Vždy keď odkrúcate ihlu, držte čierny držiak náplne. Inak môžete pero rozdeliť. Ak sa to stane, zložte pero zakrútením znova dohromady. Pred ďalším podávaním injekcie vymeňte ihlu a preskúšajte prietok inzulínu, aby ste sa uistili, že si podávate celú dávku.

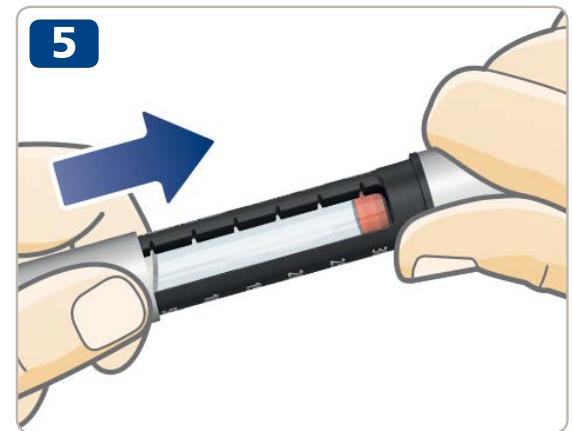

Vždy bezpečne odstráňte a zahodťte použitú ihlu, napríklad do nádoby na ostré predmety, ako vám povedal lekár. To zníži riziko upchatia ihly, kontaminácie, infekcie, a nepresného dávkowania. Neuchovávajte pero s nasadenou ihlou.

16 Ako skontrolovať koľko inzulínu zostało



Dávkovacie
tlačidlo zastalo:
zostalo 46
jednotiek



Počítadlo dávky presne zobrazí koľko inzulínu zostało v náplni, keď v nej zostało menej ako 60 jednotiek.

- **Točte dávkovacím tlačidlom**, pokým nezastane.
- Skontrolujte počítadlo dávky:
 - Ak zobrazuje "60": v náplni zostało **60 jednotiek alebo viac**.
 - Ak zobrazuje menej ako "60": **zobrazuje počet jednotiek zostávajúcich** v náplni.
- Točte dávkovacím tlačidlom naspäť, až kým počítadlo dávky zobrazí "0".

- Použite **inzulínovú stupnicu**, aby ste videli koľko inzulínu **približne** zostava v inzulínovej náplni.



Ak potrebujete viac inzulínu ako zostało v náplni, použite celú dávku z novej náplne, pozrite stranu 18.

Ak potrebujete viac ako 60 jednotiek

Ak potrebujete dávku väčšiu ako 60 jednotiek, bude potrebné **rozdeliť dávku do dvoch injekcií**. Pero podáva maximálne 60 jednotiek naraz.

Príklad

Ak si potrebujete podať 90 jednotiek:

- 1** Skontroluje prietok inzulínu.
- 2** Nastavte prvú dávku **60 jednotiek**.
- 3** Podajte si týchto 60 jednotiek.

Na dosiahnutie celej dávky 90 jednotiek **si musíte podať ďalších 30 jednotiek**.

- 4** Nastavte si druhú dávku **30 jednotiek**.
- 5** Podajte si týchto 30 jednotiek.

Teraz ste si podali celú dávku 90 jednotiek.



Budťe zvlášť opatrny, aby ste si pripravili správnu dávku, ak ju rozdeľujete do dvoch injekcií. Ak rozdelíte dávku nesprávne, podáte si príliš veľa alebo príliš málo inzulínu. To spôsobí, že hladina cukru v krvi bude príliš nízka alebo príliš vysoká.

18 Ak potrebujete viac inzulínu ako zostało v náplni



1

Ak potrebujete viac inzulínu ako zostało v náplni, **použite celú dávku z novej náplne.**

- Bezpečne odstráňte ihlu. Odkrúťte držiak náplne a odhodte použitú náplň a ihlu.
- Vložte novú náplň, *pozrite strany 2-4.*



2

- Nasadťte novú ihlu a **skontrolujte prietok inzulínu,** *pozrite strany 6-9.*

- Nastavte a podajte si **celú dávku z novej náplne,** *pozrite strany 10-13.*



Dávku môžete rozdeliť medzi dve náplne, **len ak vás zaškoli a poučil lekár.**

Ak sa pomýlite, urobíte chybu vo výpočte alebo zabudnete skontrolovať prietok, môžete si podať nízku dávku alebo sa predávkovať, čo môže viest k príliš vysokej alebo príliš nízkej hladine cukru v krvi.


Ak sa necítite dobre po tom, ako ste rozdelili dávku, skontrolujte si hladinu cukru v krvi a/alebo sa obráťte na lekára.

Ak si rozdeľujete dávku:

- 1 Preskúšajte prietok inzulínu.**
- 2** Zistite koľko presne zostało inzulínu a zapíšte si to. Točte dávkovacie tlačidlo, až kým nezastane. Počítadlo dávky potom zobrazí počet jednotiek, ktoré zostali v náplni.
- 3** Podajte si injekciou všetok inzulín, ktorý zostal v náplni.
- 4** Vyrátajte, koľko jednotiek si ešte potrebujete podať, aby ste dostali celú dávku.
- 5** Odstráňte použitú ihlu a náplň.
- 6** Vložte a pripravte novú náplň na injekčné podávanie.
- 7** Nasadte novú ihlu a **preskúšajte prietok inzulínu.**
- 8** Nastavte a podajte si zvyšok dávky z novej náplne.

20 Ako vymeniť použitú inzulínovú náplň

1

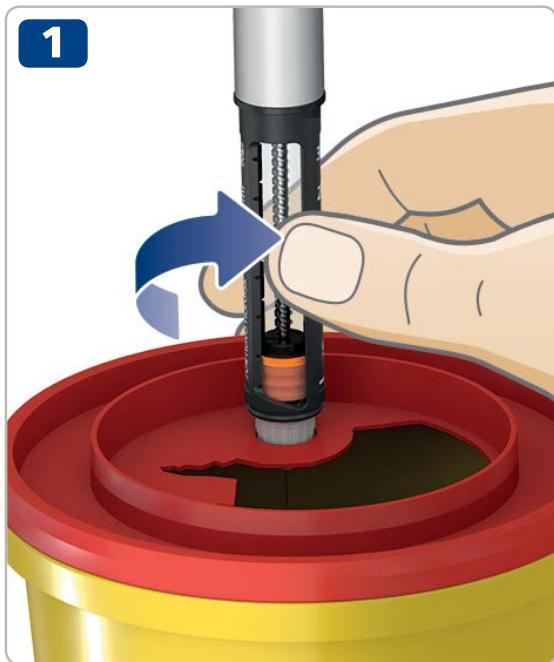

- Odstráňte a odhodte ihlu, ak je ihla ešte na pere, pozrite strany 14-15.

2




- Odkrúťte držiak náplne.



Ked' odkrútite držiak náplne, piest sa môže vysunúť z pera. Môže sa samovoľne pohnúť dozadu alebo dopredu. Zatlačte ho späť ako je opísané na strane 2.

- Nakloňte čierny držiak náplne a **nechajte náplň vykíznuť**. Odhod'te ju, ako vám povedal lekár.
- Zatlačte piest naspäť. Potom **vložte novú náplň** a zakrúťte späť držiak náplne. Nasad'te novú ihlu a preskúšajte prietok inzulínu, *pozrite strany 6-9*.

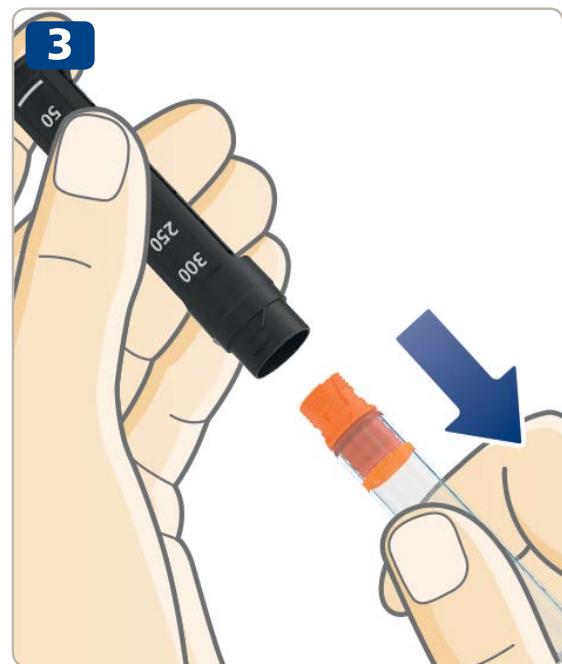

22 Ako sa starat o pero

Starostlivosť

- Používajte NovoPen® 4 iba takým spôsobom, aký je opísaný v tomto návode.
- Nenechajte pero spadnúť alebo naraziť na tvrdý povrch. Ak vám pero spadne alebo máte podezrenie na nejaký problém, skontrolujte inzulínovú náplň, či nie poškodená, napríklad prasknutá. Vymeňte náplň za novú, ak je potrebné.
- Chráňte pero pred priamym svetlom a nevystavujte ho prachu, nečistotám, ani kvapalinám alebo nadmerným teplotám.
- Nepokúšajte sa pero opravovať ani rozoberať.

Čistenie

- Pero vyčistite len jemným čistiacim prostriedkom pomocou vlhkej handričky.
- Pero neumývajte, nemamáčajte, ani nemažte a nepoužívajte výrobky obsahujúce bieliace prostriedky, chlór, jód alebo alkohol, aby ste vyčistili pero. To ho môže poškodiť.
- Ak je inzulín na povrchu pera predtým, ako zaschnie, vyčistite ho jemným čistiacim prostriedkom a vodou navlhčenou handričkou.

Uchovávanie

- Uchovávanie s vloženou inzulínovou náplňou si pozrite v písomnej informácii pre používateľa k náplníam Penfill®, ktorá sa nachádza v balení s náplňami Penfill®.
- **Neuchovávajte pero s nasadenou ihlou.**
- **Neuchovávajte pero v mrazničke alebo chladničke alebo v blízkosti chladiacej jednotky.**
- **Uchovávajte inzulínové náplne** ako je uvedené v písomnej informácii pre používateľa pre náplne 3 ml Penfill®. Tam nájdete aj informáciu o dátume exspirácie. Dátum exspirácie vytlačený na náplni sa vzťahuje na nepoužité náplne v chladničke. Nikdy nepoužívajte náplň po dátume exspirácie uvedenej na náplni alebo škatuľke.
- Pokiaľ je to možné, **uchovávajte pero v puzdre.**

Likvidácia

- **Neodhadzujte pero** s domovým odpadom.
- **Zlikvidujte pero podľa pokynov lekára, lekárnika alebo národných požiadaviek.** Myslite na životné prostredie, keď vyhadzujete pero, lebo obsahuje recyklovateľný materiál. Presvedčte sa tiež, že ste pred vyhodením pera odstránili náplň a ihlu.



24 Záruka

NovoPen® 4 sa dodáva s 3-ročnou zárukou.

Predpoklad životnosti NovoPen® 4 je päť rokov, keď sa pero používa na injekcie trikrát denne.

Ak zistíte, že pero NovoPen® 4 je pokazené, spoločnosť Novo Nordisk vám ho vymení. Vráťte ho dodávateľovi na prekontrolovanie do troch rokov, odkedy ste ho nadobudli. Priložte potvrdenie, ktoré ste dostali pri nadobudnutí NovoPen® 4.

Pre používateľov v Európskej Únii: ak počas používania NovoPen® 4 máte dôvod domnievať sa, že došlo k váznej nehode, oznámte to prosím spoločnosti Novo Nordisk a vašej národnej autorite.

Výrobca neberie na seba zodpovednosť za poruchy NovoPen® 4, ak ste nedodržali tento návod.

Ak potrebujete číslo šarže pera, nájdete ho na dávkovacom tlačidle, ako je znázornnené na obrázku vnútri obalu.

NovoPen® 4, Penfill®, NovoFine® a NovoTwist® sú chránené obchodné názvy, ktoré vlastní spoločnosť Novo Nordisk A/S, Dánsko.

Značka CE na zdravotníckej pomôcke znamená, že výrobok zodpovedá požiadavkám Smernice Medical Device Regulations (EU) 2017/745. NovoPen® 4 splňa špecifikované limity na presnosť dávkovania podľa ISO 11608-1. Injekčné perá na lekárske používanie, Časť 1: Požiadavky a metódy testovania.



CE
0123

Dátum vydania: 2019/8

© 2019
novonordisk.com

Výrobné miesto:
Novo Nordisk (Čína)
Pharmaceuticals Co., Ltd.
No. 99 Nanhai Road, TEDA
300457 Tianjin, P.R. Čína

Vyrobené pre
oficiálneho výrobcu:
Novo Nordisk A/S
Novo Alle,
DK-2880 Bagsværd, Dánsko



8-4253-62-010-5