

NovoPen Echo® Plus)

Notkunarleiðbeiningar

Lestu þessar notkunarleiðbeiningar vel áður en þú notar NovoPen Echo® Plus til inndælingar á insúlini í fyrsta skipti. Stuttar leiðbeiningar eru á bakhlið leiðbeininganna.



Efnisyfirlit

Yfirlit yfir hluta pennansInnsíða kápunnar	
KynningInnsíða kápunnar	
Mikilvægar athugasemdir1	
Undirbúningur pennans fyrir inndælingu		
Insúlínrörlykja sett í	2	
Ef notað er hvítt eða skýjað insúlín.....	5	
Ný nál sett á pennann	6	
ALLTAF skal prófa insúlínflæðið fyrir inndælingu...	8	
Skammtur valinn.....	10	
Inndæling skammts12	
Eftir inndælingu14	
Hvernig nota skal skammtaminnið		
Hvernig síðasti skammtur er athugaður	16	
Hvað sést á skjá skammtaminnisins?	17	
Hvernig persónuleg skrá yfir inndælingar er haldin	18	
Hvernig athugað er hve mikið insúlín er eftir ...	20	
Ef þú þarf meira insúlín en eftir er í rörlykjunni22	
Hvernig skipt er um notaða insúlínrörlykju24	
Villa/skilaboð á skjánum26	
Villuskilaboð	26	
„End“ birtist á skjánum.....	27	
Auður skjár	27	
Hvernig hugsa skal um pennann...	28	
Umhirða	28	
Þrif.....	28	
Geymsla.....	29	
Förgun.....	29	
Ábyrgð	30	
Tæknilegar upplýsingar	30	
Stuttar leiðbeiningar eru á bakhlíðinni		

NovoPen Echo® Plus)

Penni



Pennahetta



Insúlín-kvarði



Hylki fyrir rörlykju



Stimpilsendi

Skammtavísir

Lotunúmer
(á hinni hlíðinni)

Þrýstihnappur

Stimpilsstöng

Skammtateli

Auðkenni

Skammtaminni

Skammtaminni



Fjöldi eininga í síðustu inndælingu

Tími frá síðustu inndælingu (klst.: mínútur: sekúndur)

Einnota nál (dæmi)



Ytri nálarhetta



Innri nálarhetta



Nál



Pappírsflípi

Insúlínörlykja (Penfill® rörlykja 3 ml)



Festing fyrir nál
(til að setja á nál)

Litakóðuð merking

Glerkúla
(eingöngu í hvítu og skýjuðu insúlini)

Stimpill

Kynning

Takk fyrir að velja NovoPen Echo® Plus.

NovoPen Echo® Plus er margnota insúlinpenni með skammtaminni.

NovoPen Echo® Plus pakkningin inniheldur einn pennu, mjúkt veski og þessar notkunarleiðbeiningar.

Lestu notkunarleiðbeiningarnar vandlega áður en þú notar pennan – líka þó að þú hafir áður notað NovoPen Echo® Plus eða önnur svipuð hjálpartæki frá Novo Nordisk til inndælingar. Þær lýsa óllu sem þú þarf að vita um pennann og hvernig hann er notaður.

Notaðu eingöngu NovoPen Echo® Plus ef þú getur fylgt notkunarleiðbeiningunum að fullu. Ef þú getur það ekki skaltu fá aðstoð frá einstaklingi sem getur fylgt notkunarleiðbeiningunum.

NovoPen Echo® Plus er ætlaður til notkunar við gjöf insúlins til meðhöndlunar hjá sjúklingum með sykursýki sem þurfa insúlininndælingar.

NovoPen Echo® Plus er ætlaður til notkunar hjá sjúklingum með sykursýki sem gefa sér lyfið sjálfir, heilbrigðisstarfsfólki og umönnunaraðilum.

NovoPen Echo® Plus er ætlaður til notkunar af einum sjúklingi sem gefur sér sjálfur lyfið heima.

NovoPen Echo® Plus inndælingarpennann skal eingöngu nota ásamt viðeigandi vörum svo hann virki á nákvæman og öruggan hátt. Inndælingarpenninn er notaður ásamt Penfill® 3 ml rörlýkjum með insúlini frá Novo Nordisk og einnota náum (nálar fylgja ekki með). Notandi inndælingarpennans getur stíllt á þann skammt sem þarf frá 0,5 til 30 eininga í 0,5-eininga þrepum.

Penninn er með skammtaminni sem hjálpar þér að muna fjölda eininga í síðustu inndælingu og tímann sem liðinn er frá síðustu inndælingu. Skammtaminnið geymir einnig upplýsingar um þínar inndælingar u.p.b. síðustu þrjá mánuðina. Sjá bls. 18-19 í notkunarleiðbeiningunum

til að fá frekari upplýsingar um hvernig að nota upplýsingarnar til að halda persónulega skrá um inndælingar. Til að halda persónulega skrá er hægt að flytja upplýsingarnar til dæmis yfir í snjallsíma.

Penninn er margnota sem þýðir að þú getur notað hann aftur. Þegar þú hefur notað allt insúlini í rörlýkunni, skiptir þú einfaldlega um rörlýkju og setur nyja í. Ef þú notar meira en eina gerð af insúlini er sterkelega ráðlagt að þú notir mismunandi NovoPen Echo® Plus fyrir hverja gerð af insúlini.

Penninn fæst bæði rauður og blárr.

Mundu alltaf eftir því fyrir hverja inndælingu að athuga nafn og lit rörlýkunnar til að ganga úr skugga um að hún innihaldi réttu gerð af insúlini.

Um notkunarleiðbeiningarnar:

Í leiðbeiningunum eru gefin fyrirmæli, skref fyrir skref, um hvernig nota á pennan.

Mikilvægar upplýsingar og frekari upplýsingar eru greinilega merktar með merkjunum sem sýnd eru hér fyrir neðan:



Mikilvægar upplýsingar


Veittu þessum athugasemendum sérstaka athygli þar sem þær eru mikilvægar fyrir örugga notkun pennans. Ef þú fylgir ekki fyrirmælunum nákvæmlega getur þú fengið of lítið eða of mikið insúlin, eða ekkert insúlin.



Frekari upplýsingar

- **Ef þú ert blind/blindur eða sjónskert/ sjónskertur máttu ekki nota NovoPen Echo® Plus án hjálpar.** Fáðu hjálp frá einstaklingi með góða sjón sem getur fylgt notkunarleiðbeiningunum að fullu.
- **Prófaðu ALLTAF insúlinflæðið fyrir hverja inndælingu.** Ekki nota pennann ef ekki kemur buna af insúlini frá nálaroddinum þegar flæðið er prófað. Ef þú prófar ekki insúlinflæðið gætir þú hugsanlega fengið of lítið insúlin, eða ekkert insúlin.
- **Ef þú missir pennann** skaltu athuga hvort insúlínrörykjjan hafi skemmt, t.d. hvort sprungur hafi myndast. Ef nauðsynlegt er skal skipta um rörykjuna og setja nýja í.
- **Ef þú fyrir slysni skrúfar pennann í sundur á milli inndælinga** er mikilvægt að þú prófir insúlinflæðið fyrir næstu inndælingu. Nauðsynlegt getur verið að gera það nokkrum sinnum áður en insúlinbuna kemur frá nálaroddinum. Ef ekkert insúlin kemur gætir þú e.t.v. ekki fengið neitt insúlin.
- **NovoPen Echo® Plus er hannaður til notkunar ásamt Penfill® 3 ml rörykjju og NovoFine® Plus, NovoFine® eða NovoTwist® einnota náum, allt að 8 mm að lengd.**
- **Novo Nordisk ber ekki ábyrgð á skaða vegna notkunar NovoPen Echo® Plus með öðrum vörum en þeim sem hér er getið um.**
- **Athugaðu alltaf nafnið og litinn á rörykjunni** til að vera viss um að hún innihaldi þá gerð af insúlini sem þú átt að fá. Ef þú notar ranga gerð af insúlini mun blóðsykurinn hugsanlega verða of hár eða of lágor.
- **Hafðu aukapenna alltaf meðferðis** og auka insúlin af þeiri gerð eða þeim gerðum sem þú notar og aukanálar, ef þessir hlutir týnast eða skemmast.
- **Aldrei deila pennanum**, insúlínrörykjum eða náum með öðrum. Þetta er aðeins ætlað þér til að nota.
- **Geymdu alltaf pennann**, insúlínrörylkjurnar og nálar þar sem aðrir hvorki ná til né sjá, sérstaklega börn.
- **Geymdu pennann alltaf hjá þér.** Ekki skilja hann eftir í bílnum eða á öðrum stöðum þar sem getur orðið of heitt eða of kalt.
- **Umönnunaraðilar verða að sýna sérstaka varúð þegar þeir fjarlægja og farga notuðum náum til að forðast stunguslys og krossmengun.**
- **Ef ruglast er á insúlinum getur það haft alvarlegar heilsufarslegar afleiðingar.** Ef þú notar tvennis konar insúlin er því ráðlagt að ræða við heilbrigðisstarfsmann hvernig eigi að forðast rugling.
- **Ávallt skal lesa fylgiseðilinn** sem fylgir pakningunni með Penfill® rörykjunni, fyrir upplýsingar um insúlinið.


2 Insúlínörlykja sett í

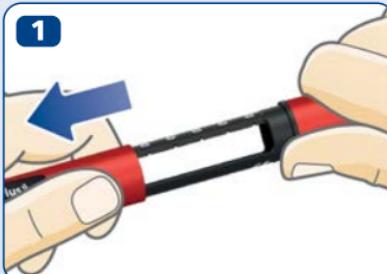

- Dragðu pennahettuna af.



- Snúðu hylkið fyrir rörlykjuna af. Leggðu það til hliðar til nota síðar.

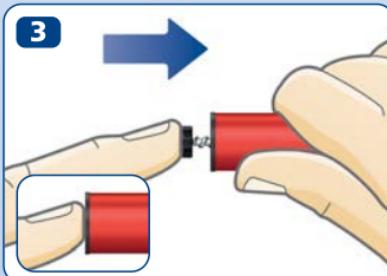

- **Stimpilsstöngin gæti staðið út** úr pennanum. Ef svo er skal þrýsta henni alveg inn þar til hún stöðvast.

i Stimpilsstöngin og endinn á stimpilsstönginni geta verið laus og hreyfst til. Það er eðlilegt og hefur ekki áhrif á virkni pennans.

- Taktu nýja insúlínrölykju. Haltu á hylkinu fyrir rörylkjuna og láttu rörylkjuna renna niður með **endann fyrir nálina fyrst** eins og sýnt er á myndinni. Liturinn á rörylkjunni getur verið annar en sá sem sýndur er á myndinni. Liturinn fer eftir því hvaða gerð af insúlíni þú notar.



Athugaðu nafnið og litinn á rörylkjunni til að vera viss um að hún innihaldi þá tegund af insúlíni sem þú þarf. Ef þú notar ranga gerð af insúlíni getur blóðsykurinn hugsanlega orðið of hár eða lágor.

Athugaðu hvort rörykjan hafi skemmt, t.d. brotnað eða lekið. Sjáðu hvernig það er gert í **fylgiseðlinum með Penfill® 3 ml rörylkju, sem er í Penfill® 3 ml rörylkju pakkningunni.**


Athugaðu hvort insúlínin líti út eins og það á að gera. Í fylgiseðlinum með Penfill® 3 ml rörylkju getur þú séð hvernig bín tegund af insúlíni á að líta út.

NovoPen Echo® Plus er hannaður til notkunar með Penfill® 3 ml rörylkju og NovoFine® Plus, NovoFine® eða NovoTwist® einnota nálum, allt að 8 mm að lengd.

4



4

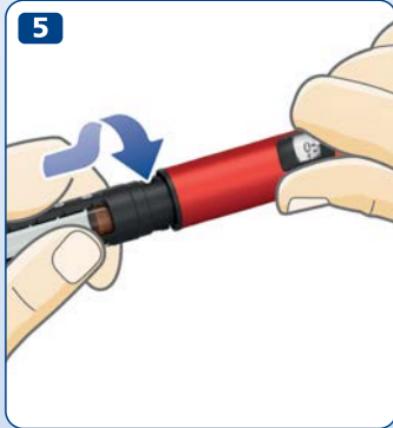

- Skrúfaðu hylkið fyrir rörlykjuna aftur á pennann eins og sýnt er á myndinni, þar til þú **heyrir eða finnur smell**.

Ef notað er hvítt eða skýjað insúlin

Ef þú notar insúlínörlyku með insúlini sem er skýjað (hvít insúlínldreifa) **skal alltaf endurblanda það rétt fyrir inndælingu.** Sjá fylgiseðil með Penfill® 3 ml rörlykju til að fá upplýsingar um hvernig á að endurblanda þína tegund af insúlini.

Gakktu úr skugga um að það sé nægilegt rými í rörlykjunni áður en þú endurblandar insúlínin:

Stimpillinn á að vera **yfir hvíta strikinu** á hylkinu fyrir rörlykjuna, þegar haldið er á pennanum eins og sýnt er á myndinni. Það er nauðsynlegt til að tryggja að glerkúlan í rörlykjunni hafi nægilegt rými til að endurblanda insúlínin.


Ef stimpillinn fer niður fyrir hvíta strikið skal skipta um insúlínörlyku og setja nýja í, sjá blaðsiður 24-25.



Hvítt strik


6 Ný nál sett á pennann

1

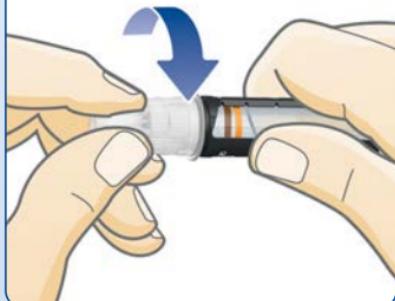

- Taktu nýja nál og fjarlægðu pappírsflipann.
- Þrýstu nálinni **beint** á pennann. **Snúðu þar til hún situr þétt.**

2

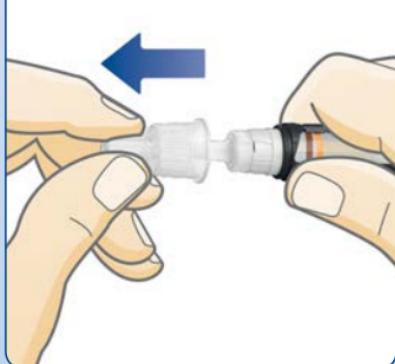

- Dragðu af ytri nálarhettuna og geymdu hana. Hana skal nota síðar eftir inndælingu, þegar fjarlægja skal notaða nál á öruggan hátt.



Notaðu alltaf nýja nál við hverja inndælingu. Það dregur úr hættunni á stífluðum nálum, mengun, sýkingum og ónákvæmri skömmtu.


Notaðu aldrei bogna eða skemmda nál.

EKKI SETJA NÝJA NÁL á pennann fyrr en þú ert tilbúin(n) að gefa næstu inndælingu.

- Fjarlægðu innri nálarhettuna og fargaðu henni.

Hugsanlegt er að dropi af insúlini sjáist á nálarroddinum. Það er eðlilegt **en engu að síður skal prófa insúlinflæðið.**

3

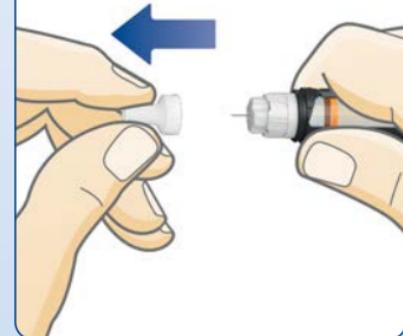

Tvær hettur eru á nálinni. Þú verður að fjarlægja báðar hettunar. Ef þú gleymir að fjarlægja báðar hettunar mun ekkert insúlin dælast inn og blóðsykurinn getur orðið of hár.

- i** NovoPen Echo® Plus er hannaður til notkunar með Penfill® 3 ml rörlýku og NovoFine® Plus, NovoFine® eða NovoTwist® einnota nálum, allt að 8 mm að lengd.

8 ALLTAF skal prófa insúlinflæðið fyrir inndælingu

1



Prófaðu ALLTAF flæðið fyrir inndælingu.

Haltu áfram að prófa þar til buna af insúlini kemur frá nálaroddinum. Þetta tryggir að holrúm eða loftbólur hafa verið fjarlægðar og að insúlin nær í gegnum nálina.

- Dragðu út þrýstihnappinn, ef hann er ekki þegar úti.

2



- Snúðu þrýstihnappnum og veldu **2 einingar**.

- **Ýttu þrýstihnappnum niður** þar til skammtateljarinn sýnir „0“. „0“ á að vera til móts við skammtavísinn.
- Athugaðu hvort buna af **insúlini komi** frá nálaroddinum.
- Ef ekkert insúlin kemur** skaltu endurtaka skref 1-3 þar til buna af insúlini kemur frá nálaroddinum.


Ef ekkert insúlin kemur í ljós eftir nokkrar tilraunir skaltu athuga í insúlin glugganum hvort bil sé á milli svarta stimpilsendans og stimpilsins, sjá mynd 3A og 3B. Ef þú sérð ekkert bil skaltu skipta um nál og athuga insúlinflæðið aftur.

Prófun á insúlinflæðinu er lokið þegar þú sérð bunu af insúlini koma frá nálaroddinum.

3



3A



3B



EKKI reyna inndælingu ef ekkert insúlin kemur í ljós.


Hugsanlega mun ekkert insúlin verða gefið, þó að skammtateljarinn færist. Það getur valdið of háum blóðsykri.

Ef ekkert insúlin kemur í ljós eftir endurteknar prófanir á flæðinu skaltu ekki nota pennann. Hafðu samband við söluaðila til að fá nýjan penna.

10 Skammtur valinn



- Dragðu þrýstihnappinn út, ef hann er ekki þegar úti.
- Vertu viss um að skammtateljarinn sýni "0" áður en byrjað er.
„0“ á að vera til móts við skammtavísinn.

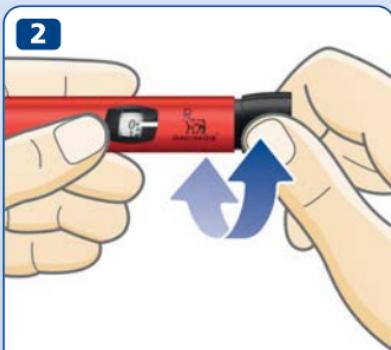

- Snúðu þrýstihnappnum til að velja þann skammt sem þarf. Snúa má þrýstihnappnum **fram og aftur** til að stilla skammtinum.



2,5 einingar
valdar



12 einingar
valdar

- i** Þrýstihnappurinn breytir fjölda eininga. Aðeins skammtateljarinn og skammtavísirinn sýna valinn fjöldu eininga í hverjum skammti. Hægt er að velja allt að 30 einingar í skammti. Hálfar einingar eru sýndar sem strik á milli talnanna.



Líttu alltaf í gegnum insúlíngluggann til að **ganga úr skugga um að insúlínið í pennanum líti út eins og það á að gera.** Í fylgiseðlinum með Penfill® 3 ml rörlykju má sjá hvernig insúlínið sem þér er ætlað á að líta út.

Notið alltaf skammtateljarann og skammtavísinn til að sjá hve margar einingar hafa verið valdar.

Ekki nota insúlkvarðann á hylkinu fyrir rörlykjuna. Hann sýnir einungis um það bil hve mikið insúlin er eftir í pennanum.

Ekki telja smellina í pennanum.

Ef stillt er á rangan fjölda eininga og þeim dælt inn mun blóðsykurinn hugsanlega verða of hár eða of lágor.

- (i)** Ef þú þarf fleiri en 30 einingar getur þú valið að nota annað tæki frá Novo Nordisk til inndælingar á insúlini með stærri hámarksskammti.

Auðvelt á að vera að snúa þrýstihnappnum. Ekki skal þvinga hann til að snúast.

Þegar færri en 30 einingar eru eftir í pennanum stöðvast skammtateljarinn við þann fjöldu eininga sem eru eftir í pennanum. *Sjá blaðsíður 22-23 ef þú þarf meira insúlin en eftir er í rörlykjunni.*

12 Inndæling skammts



Prófaðu ALLTAF flæðið fyrir inndælingu

- **Athugaðu nafnið og litinn** á rörykjunni til að tryggja að hún innihaldi þá gerð af insúlini sem þú þarf. Ef notuð er röng gerð af insúlini getur blóðsykurinn hugsanlega orðið of hár eða of lágor.
- **Vertu viss um að sjá skammtateljarann.**
- **Stingdu nálinni í húðina** eins og læknirinn eða hjúkrunarfræðingur hefur sýnt þér.
- **Ýttu þrýstihnappnum inn** þar til skammtateljarinn sýnir „0“. „0“ verður að standa til móts við skammtavísinn. Þú heyrir e.t.v. smell eða finnur fyrir honum.
- Eftir að skammtateljarinn sýnir „0“ **skaltu láta nálina vera í húðinni og telja rólega upp að 6.**

Ef nálín er fjarlægð of snemma gætir þú séð bunu af insúlini koma frá nálaroddinum. Ef það gerist hefur fullur skammtur ekki verið gefinn og þú skalt athuga blóðsykurinn oftar.

- Fjarlægðu nálinu úr húðinni.**
- Eftir inndælingu** eru upplýsingar um skammtinn geymdar í skammtaminninu. Sjá blaðsiður 16-17.



Gefðu alltaf skammt með því að ýta þrýstihnappnum inn. Ekki snúa honum. Ef þrýstihnappnum er snúið er engu insúlíni dælt inn.


Notaðu alltaf skammtateljarann til að vita hve mörgum einingum þú hefur dælt inn. Ekki telja smellina í pennanum. Skammtateljarinn sýnir nákvæman fjölda eininga.

Ef þrýstihnappurinn stöðvast áður en skammtateljarinn sýnir „0“ er nálin hugsanlega stífluð. Snúðu skammtateljaranum aftur á „0“ og skiptu yfir í nýja nál. Prófaðu insúlínflæðið og dældu inn fullum skammti.

(i) Hugsanlega kemur dropi af insúlíni í ljós á nálaroddinum eftir inndælingu. Það er eðlilegt og hefur ekki áhrif á skammtinn.

Venjuleg notkun á tækinu **getur leitt til viðbragða á stungustað**. Leitaðu til læknisins eða hjúkrunarfræðings ef þú ert í vafa.

3

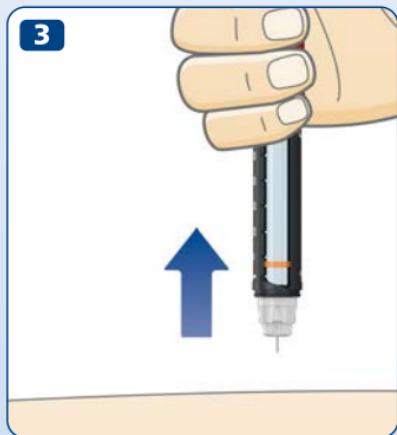

14 Eftir inndælingu

1



- Fjarlægðu nálinu strax með því að skrúfa hana af í ilát fyrir oddhvassa hluti.

2



- Ef þú ert ekki með ilát fyrir oddhvassa hluti skaltu nota aðra höndina til að setja nálarhettuna aftur á nálina. **Settu nálarroddinn inn í ytri nálarhettuna** og láttu pennann liggja á sléttu yfirborði, án þess að snerta nálina.

3



- Ekki hreyfa við ytri nálarhettunni fyrr en hún hylur nálina.
- Þegar hún hylur nálina er **ytri nálarhettunni þrýst varlega alveg á.**




Aldrei reyna að setja innri nálarhettuna á nálinni aftur.
Þú gætir stungið þig á nálinni.

- Haltu um svarta hylkið fyrir rörlykjuna og skrúfaðu nálina af. Fargaðu henni varlega eins og læknirinn eða hjúkrunarfræðingurinn hafa sagt þér.



- Settu pennahettuna aftur á pennann** eftir hverja notkun til að verja insúlinið gegn ljósi.
- Geymdu pennann vel. Penninn á að vera þar sem aðrir **hvorki ná til né sjá, sérstaklega börn**, sjá upplýsingar á blaðsiðu 29 um hvernig á að geyma pennann.

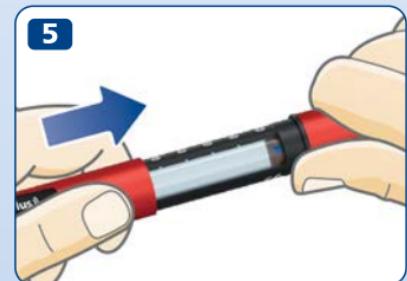

⚠ Haltu alltaf um svarta hylkið fyrir rörlykjuna þegar þú skrúfar nálina af. Annars gætir þú skrúfað pennann í sundur. Ef það gerist skaltu skrúfa pennann saman aftur. Skiptu um nál og prófaðu insúlínflæðið aftur fyrir næstu inndælingu til að tryggja að þú fáir fullan skammt.

Fjarlægðu alltaf og fargaðu notuðum nálum frá pennanum á öruggan hátt, til dæmis í ílát fyrir oddhvassa hluti, eins og læknirinn eða hjúkrunarfræðingurinn hafa sagt. Það minnkar hættuna á stífluðum nálum, mengun, sýkingu og ónákvæmri skömmtun. Ekki geyma pennann með nálinni á.

16 Hvernig síðasti skammtur er athugaður

1



2



12 einingum
dælt inn fyrir
1 klst.,
52 mínútum og
3 sekúndum
síðan



- Vertu viss um að skammteljarinn sýni „0“ áður en þú byrjar. „0“ verður að standa til móts við skammtavísinn.

- Dragðu þrýstihnappinn út og ýttu honum aftur inn.**
Ekki snúa þrýstihnappnum.

Núna sýnir skjáinn upplýsingar um síðasta skammt. Það slokknar á skjánum eftir 15 sekúndur.



EKKI SNÚA ÞRÝSTIHNAPPNUM þegar þú athugar síðasta skammt. Ef þú snýrð honum og ýtir á hann glatast upplýsingarnar um síðasta skammt. Ef þú óvart snýrð þrýstihnappnum skaltu snúa honum aftur á „0“, áður en þú ýtir honum inn. Þá glatast **EKKI** upplýsingarnar um síðasta skammt.

Hvað sést á skjá skammtaminnisins?

17

- Fjöldi eininga sem síðast var dælt inn.
- Tími sem liðinn er frá síðustu inndælingu (klst:mínútur:sekúndur).

Til hægri eru þrjú dæmi sýnd.

- **Skjáinn sýnir eingöngu upplýsingar um síðustu inndælingu eða prófun á insúlinflæði.** Það þýðir að prófun á insúlinflæði skrifar yfir upplýsingar frá síðustu inndælingu.

Skammtaminnið í pennanum geymir upplýsingar um þínar inndælingar síðstu u.p.b. þrjá mánuðina. Sjá blaðsíður 18 -19 um hvernig á að nota upplýsingarnar til að halda persónulega skrá yfir inndælingar



Skammtaminnið segir **ekki til um** hve mikið insúlin þú þarf við næstu inndælingu. Ef þú ert í vafa um hve mikið insúlin þú þarf, skaltu athuga blóðsykursmagn hjá þér. Annars áttu það á hætta að fá of mikið eða of lítið insúlin.

Ef þig grunar að skammtaminnið sýni rangar upplýsingar, til dæmis ef þú hefur meðhöndlað pennann á annan hátt en þú ætlaðir, skaltu alltaf mæla blóðsykurinn áður en þú velur skammt fyrir næstu inndælingu.

1



5,5 einingum
dælt inn fyrir
3 klst.,
45 mínútum og
10 sekúndum
síðan

2



10 einingum
dælt inn fyrir
35 mínútum og
50 sekúndum
síðan

3



8,5 einingum
dælt inn fyrir
36 klst.,
45 mínútum og
18 sekúndum
síðan

18 Hvernig persónuleg skrá yfir inndælingar er haldin

Skammtaminnið í pennanum má tengja nándarmælingum (NFC, near field communication). **Ef þú ert með snjallsíma, spjaldtölvu, tölvu, blóðsykursmæli eða annað tæki sem styður einnig NFC** getur þú fært þínar upplýsingar um inndælingar úr pennanum yfir í tækið til að halda þína eigin skrá yfir inndælingar. Þú þarfst einungis að ganga úr skugga um að tækið hafi app (smáforrit) sem getur tengst pennanum eða annan hugbúnað sem getur lesið og sýnt upplýsingar um inndælingarnar.

Skammtaminnið þarf að vera virkjað svo hægt sé að tengjast tækinu. Til að virkja skammtaminnið þarf að velja skammt sem er staðsett en núll og ýta þrósthinnappnum alveg inn. Þetta er hægt að gera með eða án insúlinrörlyku í pennanum. Ef þetta er gert með insúlinrörlyku í pennanum þarf að setja nál á pennan.

Skammtaminnið er virkjað að fullu þegar skjár skammtaminnisins sýnir upplýsingar um fyrra skammtinn sem var verið að taka. Ekki velja nýjan skammt fyrr en skammtaminnið er að fullu virkjað. Einungis þarf að virkja skammtaminnið í fyrra skiptið sem nýr penni er notaður.

1 Athugaðu hvort tækið geti tekið við nándarmælingum (NFC).

Athugaðu notkunarleiðbeiningar fyrir tækið til að kanna hvort tækið taki við NFC og nákvæmlega hvar NFC er staðsett í tækinu.

Farið á novonordisk.com/novopensmartphones til að sjá lista yfir snjallsíma sem geta tengst **NovoPen Echo® Plus**.

2 Athugaðu hvort tækið sé með „app“ (smáforrit) eða annan hugbúnað til að lesa upplýsingar um inndælingar þínar.

Ef tækið er ekki með app eða annan hugbúnað sem hentar getur þú fundið það og hlaðið niður eða haft samband við fulltrúa Novo Nordisk til að fá upplýsingar.

Farið á novonordisk.com/novopenapps til að sjá lista yfir öpp (smáforrit) sem geta tengst **NovoPen Echo® Plus**.

3 Athugaðu appið (smáforritið) eða annan hugbúnað til að kanna:

- hvernig skal undirbúa tækið til að taka við upplýsingunum.
- hvernig sýna á upplýsingar um inndælingar.





4 Upplýsingar um inndælingar fluttar yfir í tækið.

- Finnud NFC svæðið á tækinu þínu.
- Haltu skammtaminni pennans beint að NFC svæðinu á tækinu og gakktu úr skugga um að penninn haldi sambandi við NFC svæðið.
- Haltu pennanum á sama stað og bíddu á meðan upplýsingar síðustu inndælinga hafa sjálfkrafa verið fluttar yfir í tækið.



Penninn er með sérstakt auðkenni sem er staðsett á þrýstihannappnum eins og sýnt er.

Þegar inndælingaskrá þín sést á tækinu er auðkenni pennans tengt upplýsingum þínum um inndælingar.

Ef þú notar mismunandi penna fyrir mismunandi gerðir af insúlini skaltu athuga auðkenni pennans. Það sýnir frá hvaða penna upplýsingarnar um inndælingar koma.

20 Hvernig athugað er hve mikið insúlín er eftir



Skammtateljarinn sýnir nákvæmlega hve mikið insúlín er eftir í rörlykunni, þegar færri en 30 einingar eru eftir.

- Snúðu þrýstihnappnum þar til hann stöðvast.
- Athugaðu skammtateljarann:
 - Ef hann sýnir „30“: **30 einingar eða fleiri** eru eftir í rörlykunni.
 - Ef hann sýnir lægri tölu en „30“: **þá sést sá fjöldi eininga sem eftir er** í rörlykunni.
- Snúðu þrýstihnappnum til baka þar til skammtateljarinn sýnir „0“.

- Notaðu **insúlínkvarðann** til að sjá hve mikið insúlín er **um það bil** eftir í insúlínrörlykjunni.



2

Insúlínkvarði
sýnir um það
bil hve mikið
insúlín er
eftir

- i** Ef þú þarf meira insúlín en eftir er í rörlykjunni skaltu taka fullan skammt úr nýrri rörlykju, sjá blaðsíðu 22.

22 Ef þú þarf meira insúlin en eftir er í rörlykjunni

1



Ef þú þarf meira insúlin en eftir er í rörlykjunni **skaltu taka fullan skammt úr nýrri rörlykju.**

- Fjarlægðu nálina. Snúðu hylkinu fyrir rörlykjuna af og fargaðu notuðu rörlykjunni.
- Settu nýja rörlykju í, sjá blaðsíður 2-4.

2



- Tengdu nýja nál og **þrofaðu insúlinflæðið**, sjá blaðsíður 6-9.

3



- Veldu og dældu inn **fullum skammti með nýju rörlykjunni**, sjá blaðsíður 10-13.



Aðeins ef þú hefur fengið ráðleggingar frá lækninum eða hjúkrunarfræðingi máttu skipta skammtinum á milli tveggja rörlykja.

Ef þú verður annars hugar, reiknar skakkt út eða gleymir að prófa insúlinflæðið getur þú í það skiptið fengið of líttinn eða of stóran skammt sem gæti leitt til þess að blóðsykurinn verði of hár eða of lágor.

Ef þér liður illa eftir að hafa skipt skammti skaltu mæla blóðsykurinn og/eða hafa samband við lækninn eða hjúkrunarfræðing.

Ef þú skiptir skammtinum:

- 1 Prófaðu insúlinflæðið.**
- 2** Athugaðu nákvæmlega hve mikið insúlin er eftir og skrifaðu það hjá þér. Snúðu þrýstihnappnum þar til hann stöðvast. Skammtateljarinn sýnir þá fjölda eininga sem eftir eru í rörlykjunni.
- 3** Dældu inn öllu insúlinu sem er eftir í rörlykjunni.
- 4** Reiknaðu út hve margar einingar þú þarf í viðbót til að fá fullan skammt.
- 5** Fjarlægðu notuðu nálina og rörlykjuna.
- 6** Settu nýja rörlykju í og undirbúðu hana til inndælingar.
- 7** Settu nýja nál á pennann og **þrófaðu insúlinflæðið.**
- 8** Veldu afganginn af skammtinum og dældu honum inn með nýju rörlykjunni.



Ef þú skiptir skammtinum og gefur tvær inndælingar mun skjár skammtaminnisins aðeins geyma upplýsingar um seinni inndælinguna.


24 Hvernig skipt er um notaða insúlínörlykju

1



- Fjarlægðu nálinu af pennanum og fargaðu henni, ef hún er enn á pennanum, sjá blaðsiður 14-15.

2

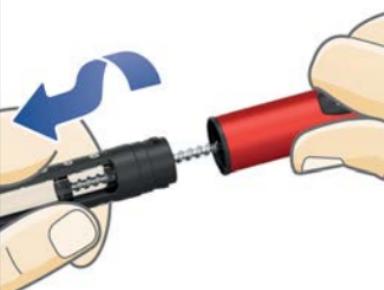

- Snúðu hylkinu fyrir rörlykjuna af.



Þegar þú snýrð af hylkinu fyrir rörlykjuna mun stímpilsstöngin standa út úr pennanum. Hún getur færst til af sjálfu sér. Þróstu henni aftur inn eins og sýnt er á blaðsiðu 2.

- Hallaðu hylkinu fyrir rörlykjuna og **láttu rörlykjuna renna út**. Fargaðu henni eins og læknirinn eða hjúkrunarfræðingur hefur sagt fyrir um.
- Þrýstu stimpilsstönginni aftur inn. **Settu síðan nýja rörlykju í** og snúðu hylkinu fyrir rörlykjuna aftur á pennann. Settu nýja nál á og prófaðu insúlinflæðið, sjá blaðsiður 6-9.



26 Villa/skilaboð á skjánum



Villuskilaboð

Síðasta inndæling ekki skráð í skammtaminnið

Ef þú séð þessi skilaboð hefur þú fengið insúlínið sem þú dældir síðast inn en skammtaminnið hefur ekki skráð inndælinguna.

Hvað skal gera?

Penninn dælir enn insúlíni. Ef þú manst ekki hversu miklu og hvenær þú dældir síðast inn insúlíni skaltu mæla blóðsykurinn oftar en einu sinni áður en þú dælir meiri insúlíni inn.

Venjulega byrjar skammtaminnið að virka aftur eftir næstu inndælingu. Ef ekki, hafðu þá samband við söluaðila til að fá nýjan penna.

Rafhlaðan virkar ennþá.



„End“ birtist á skjánum

Penninn nálgast fyrningu

Rafhlaðan fer að verða tóm og skammtaminnið nálgast fyrningu.

Hvað skal gera?

Hafðu samband við söluaðilann til að fá nýjan penna. Þú getur áfram notað pennann til inndælingar á insúlíni þar til þú færð nýjan.

Skammtaminnið virkar en nálgast fyrningu. Að loknum líftíma pennans verður skjáinn auður.

Endingartími pennans er fjögur til fimm ár. Sjá upplýsingar um ábyrgð á blaðsiðu 30.



Auður skjár

Skammtaminnið er óvirkt eða rafhlaðan tóm

Skammtaminnið hefur ekki verið virkjað eða rafhlaðan er tóm.

Hvað skal gera?

Gakktu úr skugga um að skammtaminnið hafi verið virkjað. Skammtaminnið virkjast þegar þú notar NovoPen Echo® Plus í fyrsta skipti.

Ef þú hefur notað NovoPen Echo® Plus til inndælingar: Dragðu þrystihnappinn út og þrystu honum síðan inn aftur til að sjá upplýsingar um síðustu inndælingu. Ef skjáinn sýnir ekkert eftir það er rafhlaðan tóm.

Hafðu samband við söluaðilann til að fá nýjan penna. Þú getur áfram notað pennann til inndælingar á insúlíni þar til þú færð nýjan. Sjá upplýsingar um ábyrgð á blaðsiðu 30.

28 Hvernig hugsa skal um pennann

Umhirða

- Notaðu NovoPen Echo® Plus aðeins eins og lýst er í þessum notkunarleiðbeiningum.
- **Þú mátt ekki missa pennann** eða reka hann í hart yfirborð. Ef þú missir hann eða grunar að hann sé bilaður skaltu athuga hvort insúlnrörlykjan hafi skemmt, t.d. hvort sprungur hafi myndast. Skiptu um rörlykju og settu nýja í ef þú telur það nauðsynlegt.
- **Haltu pennanum frá** beinu sórlarljósi, ryki, óhreinindum, vökva og háum hita.
- **Ekki reyna að gera við pennann** eða taka hann í sundur.
- Penninn er með innbyggða litíum-rafhlöðu. Af öryggisástæðum er ekki hægt að skipta um hana. Þegar rafhlaðan er tóm skaltu hafa samband við söluaðilann til að fá nýjan penna. Þú getur áfram notað pennann til inndælingar á insúlini án þess að nota skammtaminnið.



Líftími rafhlöðunnar er fjögur til fimm ár ef fyrsta notkun hans er fyrir dagsetninguna sem prentuð er við hliðina á þessu merki á ytri umbúðunum.

Prif

- Aðeins má þrífa pennann með rökum klúti sem aðeins er vættur með **mildu hreinsiefni**.
- **Þú mátt ekki þvo pennann, leggja hann í vatn eða smyrja hann.** Ekki nota efni sem innihalda bleikiefni, svo sem klór, joð eða etanól til að þrífa pennann. Það getur skemmtt hann.
- Ef insúlin lendir á pennanum **skaltu þrífa það áður en það börnar** með rökum klúti sem er aðeins vættur með mildu hreinsiefni.

Geymsla

- Sjá upplýsingar um geymsluskilyrði í fylgiseðli sem fylgir með Penfill® 3 ml rörlykju pakkningsunni ef penninn er geymdur með Penfill® 3 ml rörlykju.
- Geymu pennann við stofuhita ef hann er ekki með insúlínrorlykju.
- **Ekki geyma pennann með nálinni á.**
- **Penninn má ekki frjósa** eða vera geymdur í kæli við hliðina á kaelieiningu.
- **Geymu insúlínrorlykjuna** eins og getið er um í fylgiseðlinum með Penfill® 3 ml rörlykjum. Þar getur þú einnig séð upplýsingar um fyrningardagsetningu. Fyrningardagsetningin sem prentuð er á rörlykjuna gildir fyrir ónotaðar rörlykjur í kæliskáp. Notaðu aldrei rörlyku eftir að fyrningardagsetningin á rörlyjunni eða á pakkanum er liðin.

Förgun

- **Ekki má farga pennanum** með heimilissorpi.
- **Fylgdu ráðleggingum læknisins, hjúkrunarfræðings, lyfjafræðings eða yfirvalda um förgun pennans.** Hafðu umhverfið í huga þegar þú fargar pennanum. Hann inniheldur litíum rafhlöðu, rafhluta og endurunnið efni. Gættu þess að fjarlægja nálina og insúlínrorlykjuna áður en þú fargar pennanum.
- Umbúðirnar má endurvinna.



Farga skal raftækjum aðskildum frá öðrum úrgangi.

Ábyrgð

Ábyrgðartími NovoPen Echo® Plus er 3 ár, sem nær einnig til skammtaminnisins.

Ef þú kemst að því að NovoPen Echo® Plus er bílaður mun Novo Nordisk láta þig hafa nýjan. Skilaðu honum til söluaðilans til rannsóknar innan þriggja ára frá því að þú fékkst hann. Sendu kvittunina með frá því að þú félust Hann. NovoPen Echo® Plus pennann.

Ef grunur leikur á að alvarlegt atvik (aukaverkun) hafi átt sér stað meðan á notkun NovoPen Echo® Plus stendur, skal tilkynna það til Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is.

Framleiðandinn tekur ekki á sig ábyrgð á bilunum á NovoPen Echo® Plus pennanum, ef bessum leiðbeiningum hefur ekki verið fylgt.

Ef þér finnst upplýsingarnar sem fylgja með bessum notkunarleiðbeiningum vera rangar skaltu hafa samband við söluaðilan til að greiða úr vandamálinu.

Ef þú þarf að nota lotunúmer pennans er það að finna á þrýstihnappnum eins og lýst er á myndinni á innri síðu kápunnar.

NovoPen Echo®, Penfill®, NovoFine® og NovoTwist® eru skrásett vöruumerki í eigu Novo Nordisk A/S, Danmörku.

N Mark er vöruumerki eða skrásett vöruumerki NFC Forum, Inc. í Bandaríkjunum og í öðrum löndum.

Tæknilegar upplýsingar

Novo Nordisk A/S lýsir því hér með yfir að gerð NovoPen Echo® Plus fyrir útværpsbylgjur er í samræmi við tilskipun Evrópusambandsins 2014/53/EU. Heildartexta EU-tilskipunar má finna á eftirfarandi vefsíðu:

<http://bit.ly/NovoPenEchoPlus>

NovoPen Echo® Plus uppfyllir sértæk fráviksmörk um skammtanákvæmni samkvæmt staðlinum ISO 11608-1. Pen-Injectors for Medical Use, Part 1: Requirements and test methods.

Geymsla og notkunarskilyrði

Án insúlínþrýlkju:

- Hitastig: 5 °C til 40 °C
- Rakastig: 15% RH til 93% RH
- Loftþrystingur: 700 hPa til 1060 hPa.

Með insúlínþrýlkju:

Sjá leiðbeiningar í fylgiseðli með Penfill® 3 ml rörlykju sem fylgir með pakkningu Penfill® 3 ml rörlykju.

Notkunaráttur

Til samfelldrar notkunar.

Vörn gegn innstreymi

NovoPen Echo® Plus er flokkaður samkvæmt Ingress Protection sem IP52, þar sem:

- 5 þýðir vörn gegn skaðlegu magni af ryki.
- 2 þýðir vörn gegn vatnsdropum sem falla lóðrétt þegar lokuðu einingunni er hallað um allt að 15°.

NovoPen Echo® Plus er ekki vatnsheldur.

Innstreymiseinkunnin IP52 þýðir að tækið er einungis vatnshelt undir ákveðnum kringumstæðum, og því er mælt með að halda pennanum frá vatni og öðrum vökva.




Vörn gegn raflosti

Gerð: Internally Powered ME Equipment.
Stig: Type BF Applied Part.

Rafsegulssamhæfni

Þó að penninn sé hannaður með vörn gegn skaðlegum truflunum við heimilisaðstæður þá gefur NovoPen Echo® Plus frá sér, notar og getur geislæð orku á tíðni útvarpsbylgja (RF). Því getur orðið truflun við vissar aðstæður.

Inndælingunum er ekki stjórnað með rafeindatækni og skammtanákvæmni verður því ekki fyrir truflunum frá rafsegulsviði.



CE
0123

Útgáfudagsetning: 09/2023

© 2023
novonordisk.com

Framleiðandi:
Novo Nordisk (China)
Pharmaceuticals Co. Ltd.
99 Nanhai Road, TEDA
300457 Tianjin, Kína

Fyrir:
Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd, Danmörk

8-4261-41-040-3

